


Przetworniki różnicy ciśnień z separatorami bezpośrednimi

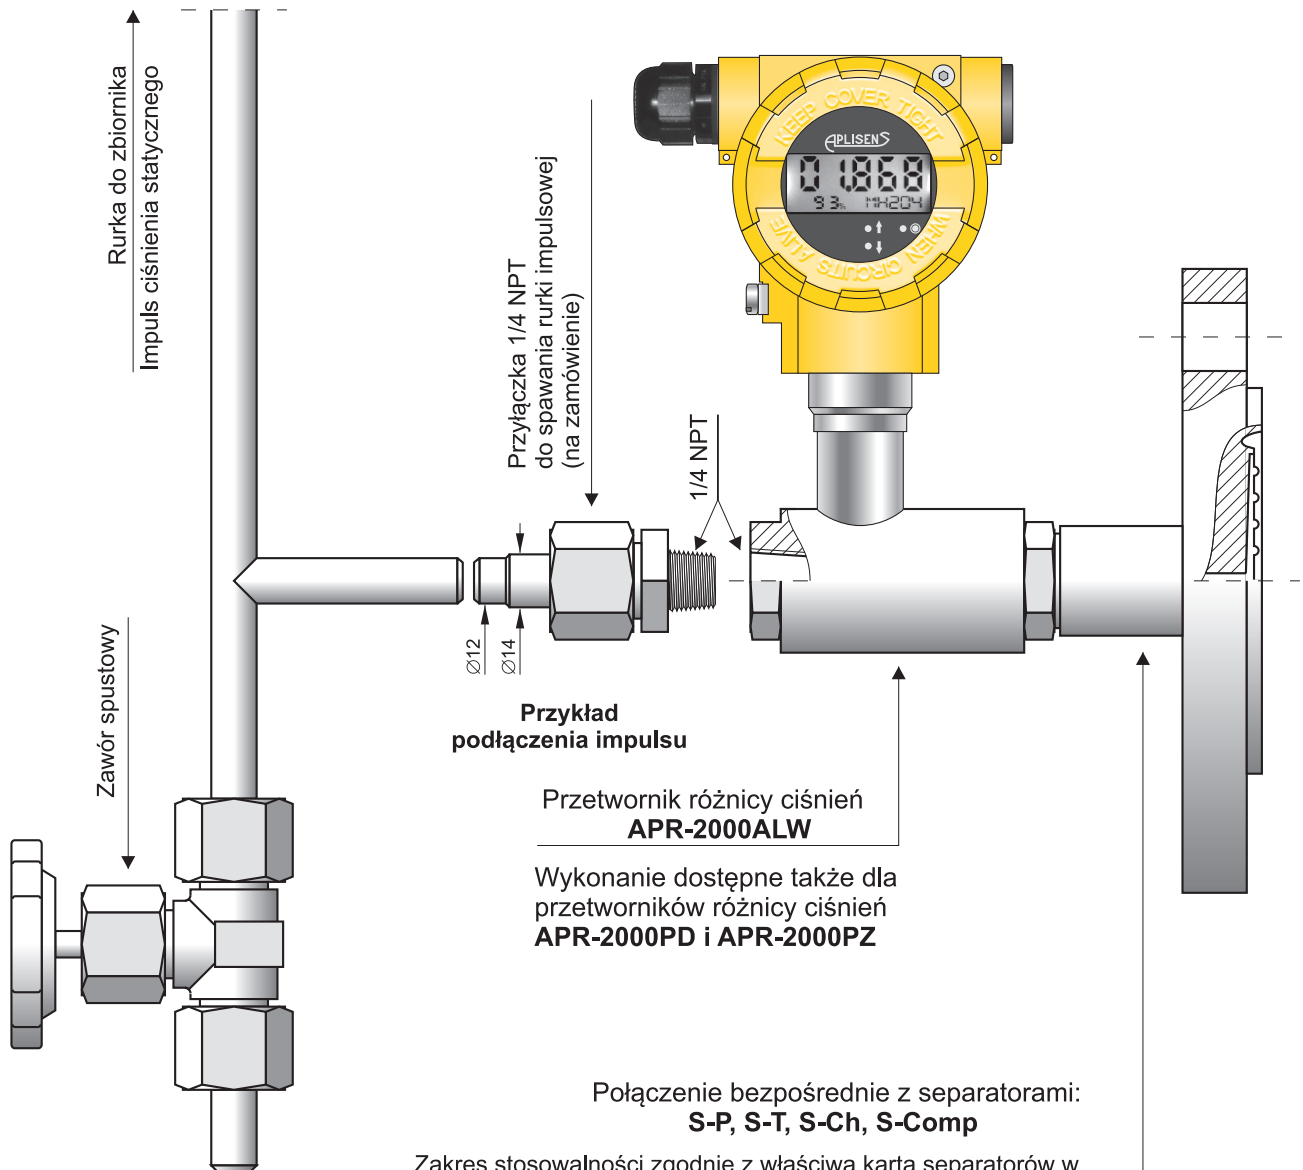

Zakres stosowalności zgodnie z właściwą kartą separatorów w rozdziale III (Separatorzy) w odniesieniu do separacji bezpośredniej.

Sposób zamawiania

przetwornik różnicy ciśnień / separator

Przetwornik różnicy ciśnień – kod zgodnie z właściwą kartą katalogową

Separator – kod zgodnie z właściwą kartą katalogową (Rozdział III – Separatorzy)

Przykład – przetwornik do pomiaru poziomu w zbiorniku zamkniętym z zalaną rurką impulsową:
Przetwornik różnicy ciśnień APR-2000PD, zakres podstawowy $-50 \div 50$ kPa, zakres nastawiony $-4 \div 0$ m H₂O, separator kołnierzowy płaski DN80.

APR-2000PD / $-50 \div 50$ kPa / $-4 \div 0$ m H₂O / S-P – DN80